




一般財団法人 日本食品検査
Japan Food Inspection Corporation

本部・首都圏事業所概要




JS プログレビル外観

3階平面図 本部・首都圏事業所

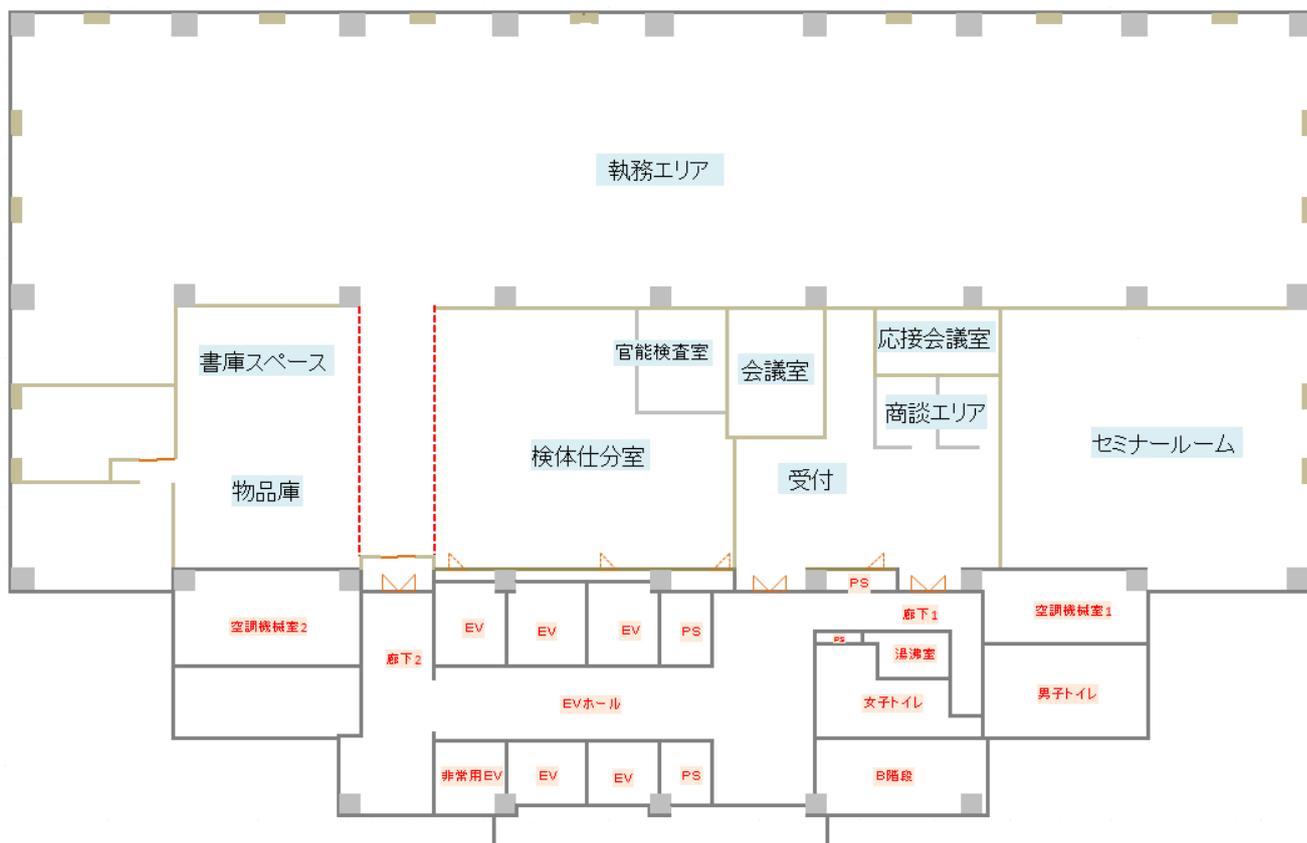

組織図

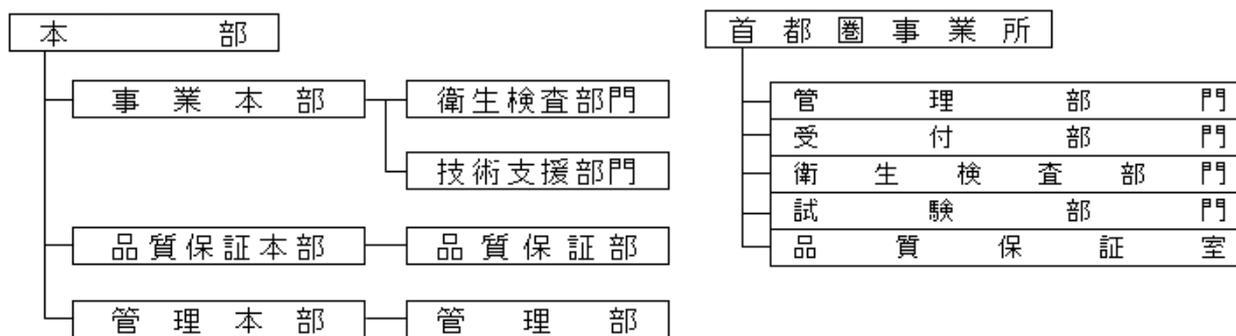


職員数 本部：42名 首都圏事業所：88名 計 130名

フロア面積 (3階、4階共通)

総床面積	1,499.57 m ²
専有部分	1,164.13 m ²
共有部分	335.44 m ²

4階平面図 首都圏事業所試験室

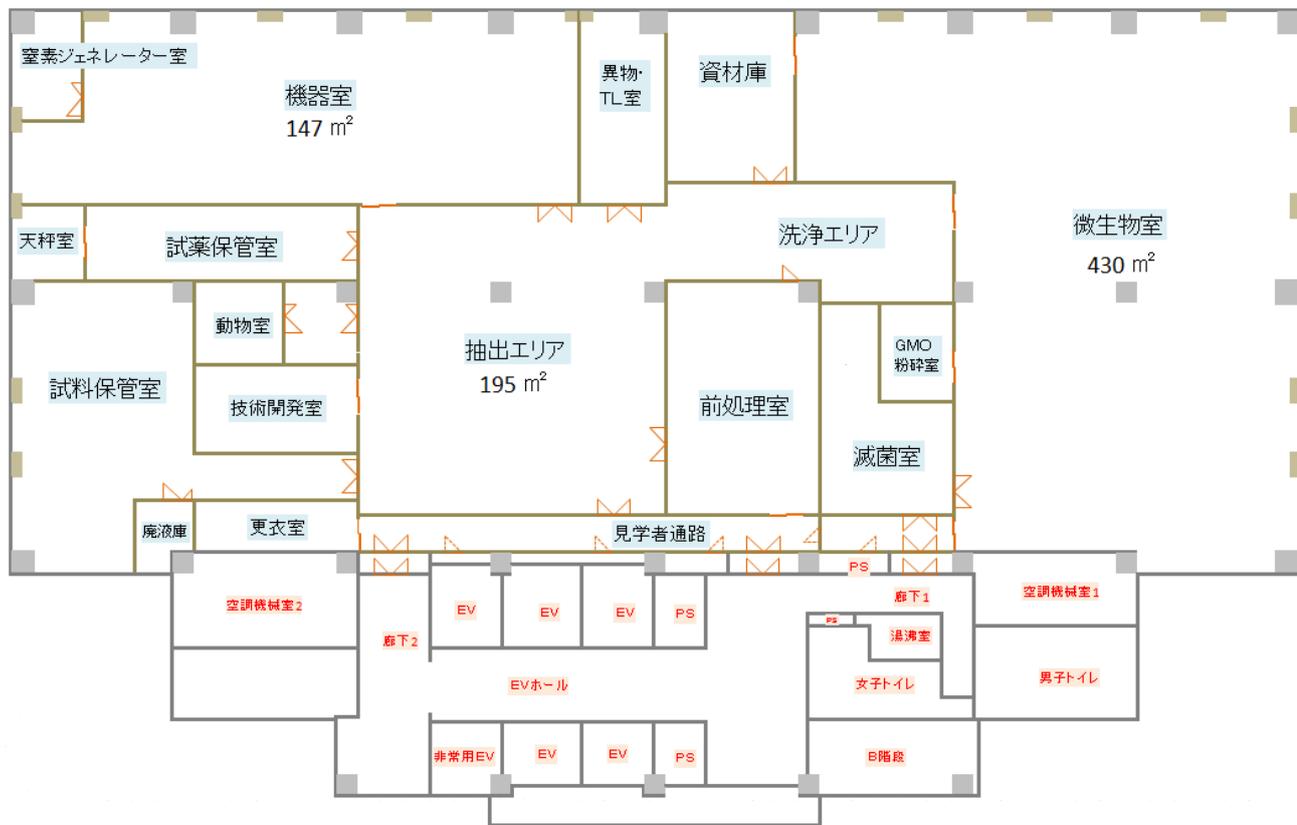

試験内容：残留農薬・動物薬、化^レ毒、添加物、放射能、貝毒、異物、微生物、遺伝子

主要機器・設備：

機器室 ガスクロマトグラフ、ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフタンデム質量分析計、高速液体クロマトグラフ、高速液体クロマトグラフタンデム質量分析計（三連四重極、四重極オービトラップ）、ガンマ線スペクトロメータ（ゲルマニウム半導体検出器）、原子吸光光度計、蛍光光度計、分光光度計

抽出エリア 紫外線鑑別装置、遠心濃縮装置、超純水製造装置

前処理室 超遠心粉砕機


微生物室 クリーンベンチ、安全キャビネット、ふ卵器、恒温槽、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温恒湿器、遺伝子解析装置（サーマルサイクラー、リアルタイムPCR装置、画像解析装置）、実体顕微鏡、光学顕微鏡、自動免疫蛍光測定装置

建物概要	名 称	J S プログレビル
	構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	規 模	地下1階、地上11階
	延床面積	17,868.72 m ² (5,405.28 坪)

■ アクセス (地図)

電車でお越しいただく場合

- ・ 京浜急行本線品川より平和島まで約 12 分
- ・ 東京モノレール浜松町より流通センターまで約 10 分
- ・ 京浜急行本線横浜より平和島まで約 16 分
- ・ 東京モノレール羽田空港より流通センターまで約 14 分

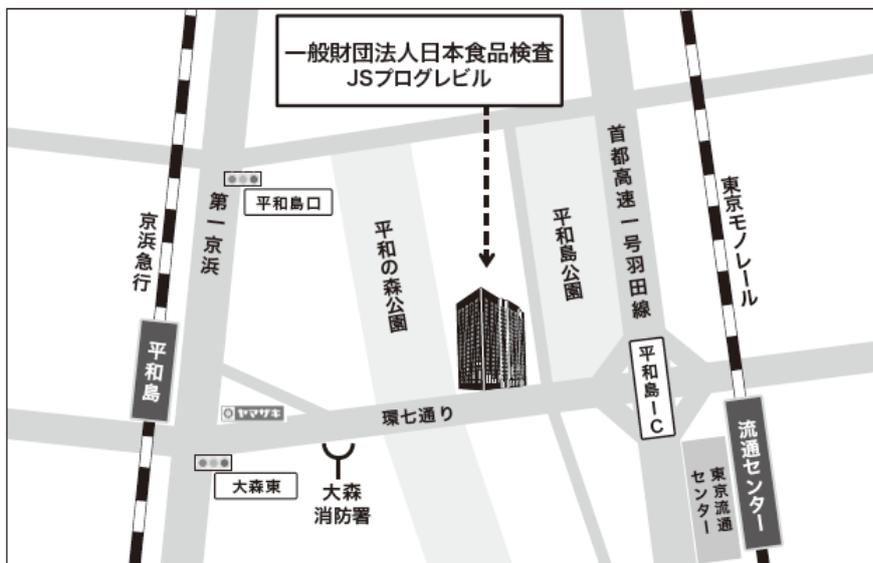

※平和島駅より徒歩 8 分、流通センター駅より徒歩 12 分

◎京急平和島からの徒歩ルート



東京都大田区平和島四丁目 1 番 23 号 JS プログレビル 3,4 階

TEL 03-6436-8770 FAX 03-3765-1680